

Mê Linh, ngày 07 tháng 08 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa máy thở xách tay cho Bệnh viện Đa khoa Huyện Mê Linh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

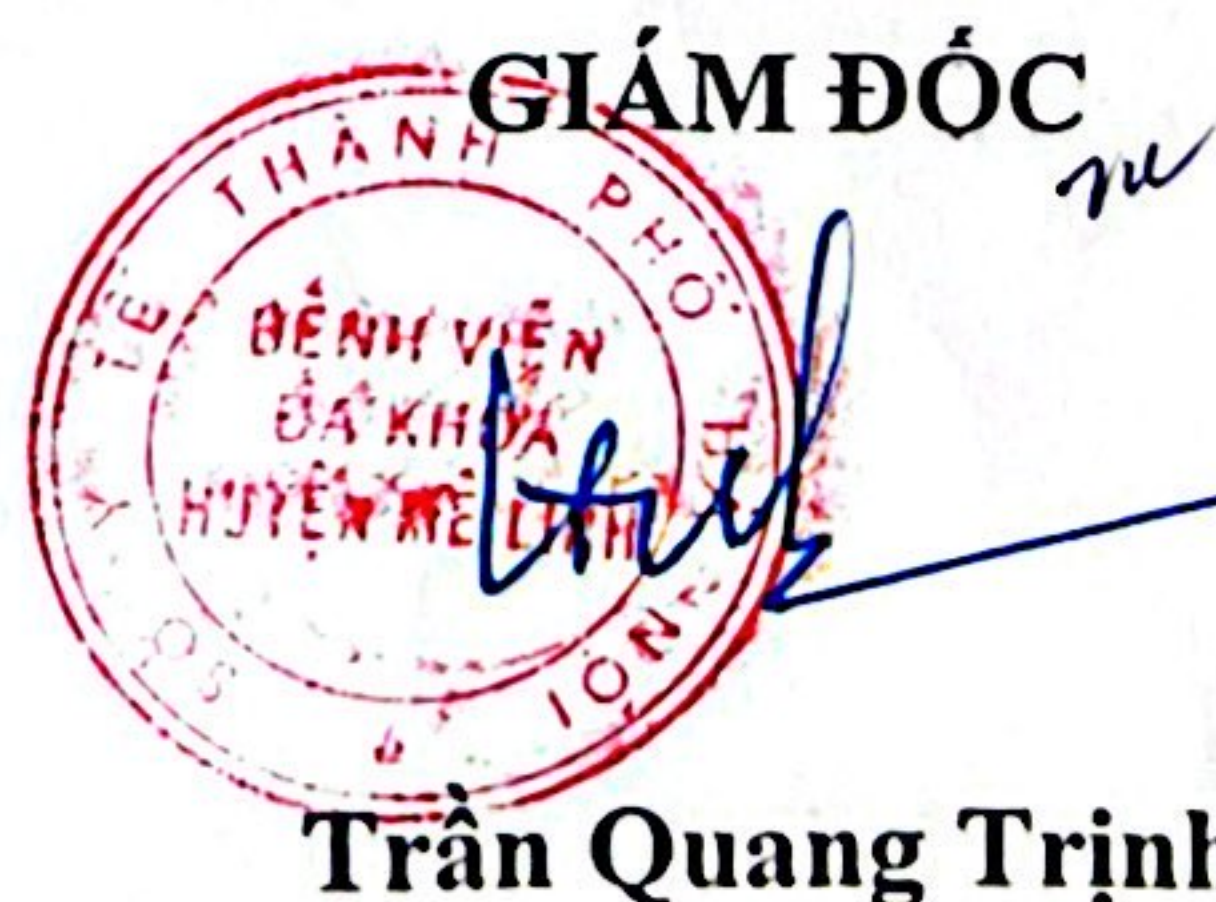
- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh
- Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Ngọc Thanh – KHTH&VTYT (SĐT: 0978987669)
- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh – Thôn 1, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
- Thời hạn nhận báo giá: Từ 10h ngày 07/08/2025 đến trước 10h 18/08/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

- Thời hạn hiệu lực báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục này.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Nội dung công việc	Mô tả dịch vụ	SL
	Sửa chữa máy thở xách tay. - Model: Falco 202EVO - Hãng sản xuất: Siare/ Ý	Sửa chữa, thay Bo mạch giao tiếp, bộ kết nối oxy sensor, pin 12v 4Ah, cảm biến oxy cho máy thở xách tay.	
1	Thay Bo mạch giao tiếp		01 Cái
2	Thay bộ kết nối oxy sensor		01 Cái
3	Thay pin 12v 4Ah		01 Cái
4	Thay cảm biến oxy		01 Cái

GIÁM ĐỐC

Trần Quang Trịnh